

## Circular Informativa

---

N.º 016/CD/8.1.7.

Data: 27/01/2014

Assunto: **Perfluoroctano Meroctane – fabricante MERAN TIP**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

---


Em Espanha e no Chile, após a utilização, em cirurgias da retina, do dispositivo médico **Meroctane (perfluoroctano)** do fabricante **Meran Tip**, sedeadado na Turquia, verificou-se, em alguns doentes e no período pós-operatório, perda da acuidade visual e danos graves na retina.

Considerando a severidades dos incidentes, a Autoridade Competente Espanhola recomendou a suspensão da utilização e recolha deste dispositivo médico do mercado espanhol.

Assim, e apesar de não haver registo da comercialização deste dispositivo médico no mercado nacional nem da ocorrência de eventos adversos, o Infarmed recomenda:

- A verificação, nas unidades de saúde nacionais, da existência de embalagens deste dispositivo médico;
- Em caso de deteção das mesmas, a sua colocação em quarentena e o contacto imediato com a Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed (tel: + 351 21 798 71 45; fax: + 351 21 798 73 67 ou e-mail: [dvps@infarmed.pt](mailto:dvps@infarmed.pt)).

O Conselho Diretivo

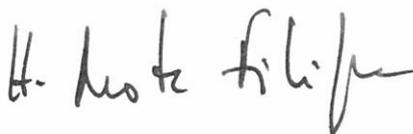

Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Diretivo

